


スペクトルNo. K-K01

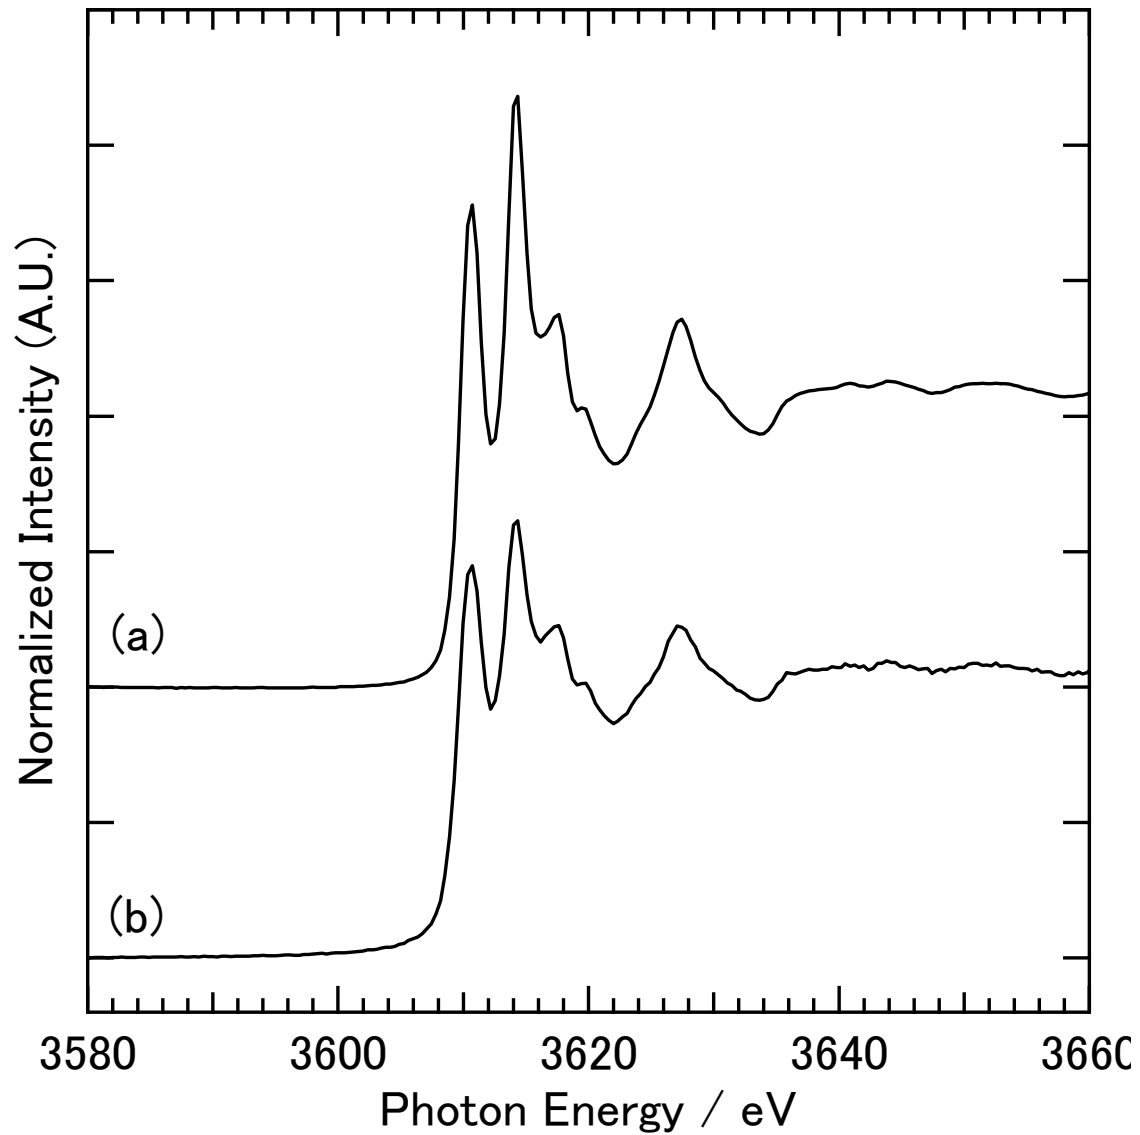

試料	KCl
吸収端	K K-edge
ビームライン	BL11
分光結晶	Si(111)
測定法	(a)CEY (b)PFY
エネルギー範囲 / eV	3400 -3852 eV
ポイント数	550
測定時間 / min	34
測定日	2019/2/20
コメント	・粉末試料/カーボン 両面テープ ・エネルギー未補正