


NEXAFS spectra of TiO₂

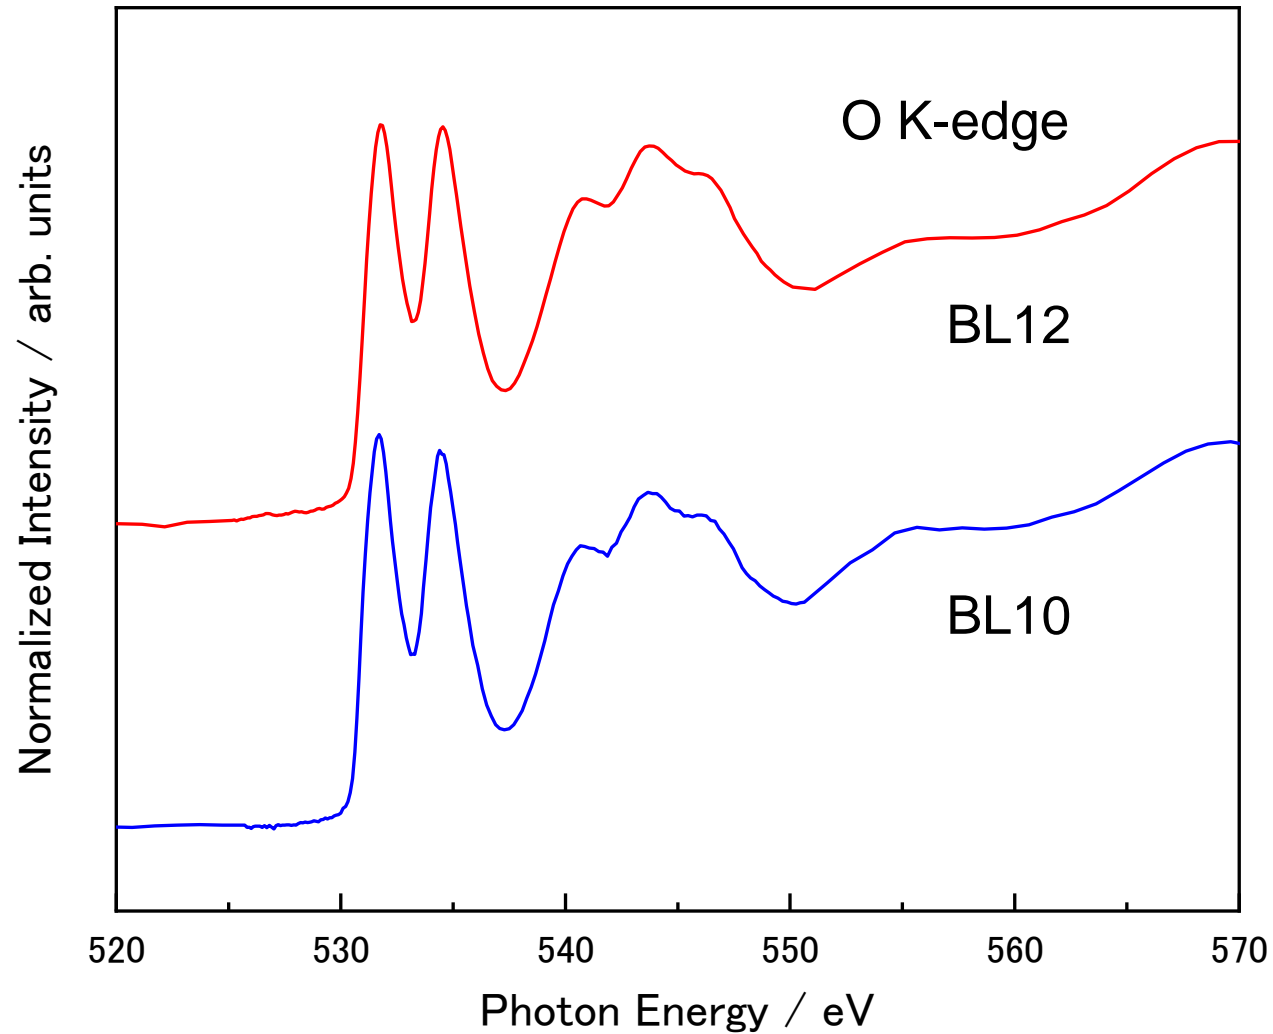

試料: TiO₂粉末/カーボンテープ固定

測定日: 2017年12月

検出手法: 全電子収量法(TEY)

回折格子中心刻線密度(lines/mm):
1200 (BL10)、600 (BL12)

分光器スリット(μm): 20/20

測定点、取り込み時間: 201点 × 1秒